Råd för felsökning och lättare åtgärdslösningar

Växjö kommun

för Ep-larm HSL-skyddsåtgärdslarm ordinerade av sjuksköterska

Dessa råd är till för dig som upptäcker att ett EP-larm inte fungerar. Följ stegen innan du kontaktar ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan kontaktar sedan larmsamordnare i Växjö kommun.
Det ska alltid finnas en bruksanvisning och vid behov en anpassad manual för larmen.

---

1. **Är larmet påslaget?**
   Kontrollera att alla delar som hör till EP-larmet är påslagna.
2. **Sitter larmet på rätt plats?**
   Exempel: på handleden, under sängen eller i sängen.
3. **Kontrollera kablar och kontakter**
   Se att kablarna är hela och inte skadade. Alla kontakter ska sitta ordentligt och vara anslutna till ström.
   (Om kablar är skadade, gå till punkt 10.)
4. **För EPIsafe-larm (med sensor):**
   - Kontrollera att sensorn är laddad och går att ladda.
   - Testa att sensorn reagerar när du skakar handleden.
     Se bruksanvisningen för detaljer.
5. **Byt batterier vid behov**
   - I kopplingsdosorna (INKA/Mbox) finns 2 st AAA- eller AA-batterier.
   - Batterilarm visas på personalens mottagare (se rutin för batterivarning).
   - För att byta: använd en liten stjärnskruvmejsel, skruva bort de fyra svarta skruvarna och sätt i nya batterier.
   - **Viktigt:** byt batterier i alla kopplingsdosor som hör till larmet, samt i själva EP-larmet om det finns. Se manual/bruksanvisning.

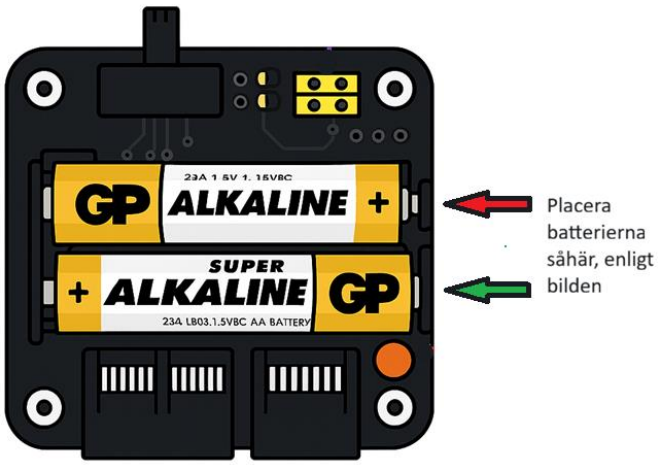

6. **Kontrollera att batterierna sitter rätt**
   Plus (+) ska mot plus och minus (-) mot minus. Se bild i manualen.
7. **Testa larmet efter batteribyte**
   Kontrollera att personalens mottagare är påslagen. Om larmet inte fungerar, kontrollera batteriernas placering igen.
8. **Om larmet fungerar efter testet**
   Allt är **OK**.
   Om inte, gå vidare till punkt 9.
9. **Kontrollera personalens mottagare**
   Är mottagaren påslagen? Om inte, starta den enligt bruksanvisningen.
10. **Om larmet fortfarande inte fungerar**
    - Kontakta ansvarig sjuksköterska. (*Sjuksköterskan skickar meddelande via LifeCare till HSL-larmsamordnare).*
    - Kontakta ansvarig chef eller beredskapschef enligt rutin.